Dist-Inject

Mode d'emploi pour seringue aluminium.

Graisser Légerement le piston en cautchou au moyen du lubrifiant silicone

Indroduiser la capsule d'injection dans la cavité du piston de façon à ce que l'extrémité mobile de la capsule soit vers l'extérieur.
Mettre le tout dans le cylindre de la seringue etle faire passer a traver le cylindre une ou deux fois à l'aide du bâton gris pour que l'interieur du cylindre soit bien graissé

Placer le piston avec la capsule de nouveau dans le cylindre et pousser le assez profondement pour que le stabilisateur puisse être vissé sur le cylindre

La quantité de médicament voulue est alors versée par lêxtrémité ouverte du cylindre. Le niveau du liquide doit arriver au début du filetage. Si tel n'est pas le cas,compléter avec de l'eau distillée. Fermer le cylindre en vissant la canule choisi.

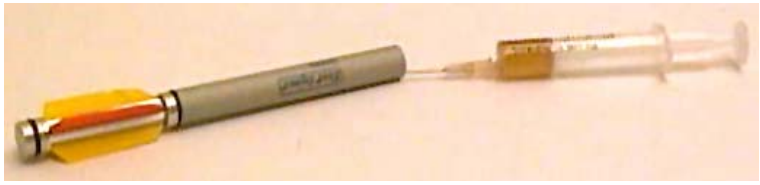

Attention ! la seringue est prête à l'usage.
Ne pas laisser tomber la seringue car la capsule d'injection peut se déclancher et faire ejecter le medicament.

Entretien de la seringue
Les seringues utilisées sont démontées, nettoyées aprés chaque usage et stérilisée de temps en temps.
Si une seringue préparée n'est pas utilisée, le médicament ne doit pas rester plus de quelques heurs dans le cylindre en alu.

Important.
Cylindre et stabilisateur peuvent se déformer aprés plusieurs usages. En cas de doute, pousser la seringue avant l'utilisation au moyen du bâtonnet de nettoyage (sans brosse) au travers du canon. La résistance de frottement ne doit pas être trop grande. Si c' est le cas, contrôler le cylindre et le stabilisateur en vérifiant s'il y a des restes de poudre sous le joint toute à l'arrière du stabilisateur ou des déformations de pieces. Il peut aussi arriver, que le stabilisateur et/ou la canule soient trop serrés ou que le cylindre soit gonflé.

Attention !
Des pieces déformées ou endomagées ne doivent plus être utilisees, le fonctionnement ne serait plus garanti.

Utiliser les capsules d'injection suivents pour le different volume des cylindres
.
Art.Nr. 2006 Pour seringues de 1 - 5 ml 1 point
Art.Nr. 2007 Pour seringues de 7 - 10 ml 2 points
Art.Nr. 2008 Pour seringues de 15 ml 3 points

19.09.2002 10:24:00